



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011


Version: 01

Page 1 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

(**) Le délai de remise est en fonction du bilan, il est calculé par ProLab et il est indiqué sur le reçu du patient.

Ac anti cellules pariétales (AACP)



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Alegria ELISA automatisée	Seuil 10 U/ml	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 2 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ac anti-ccp



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Alegria ELISA automatisée	< 20 U/ml Négatif ≥ 20 U/ml Positif	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 3 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ac anti-DNA natif

ANTI DNA



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervales de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Alegria ELISA automatisée	< 25 U/ml Négatif ≥ 25 U/ml Positif	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 4 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ac anti facteur intrinsèque AFI

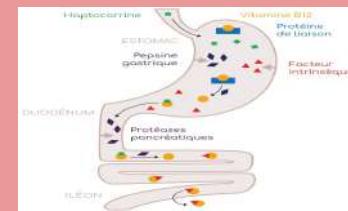

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	ALEGRIA ELISA automatisée	Seuil 6 U/ml	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 5 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ac anti nucléaires



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	IFI	1/100	ND	Analyse différée




Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 6 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri



Ac anti-phospholipides (IgG + IgM)

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Alegria ELISA Automatisée	< 10 MPL-U/ml Négatif ≥ 10 MPL-U/ml Positif	<u>24 H</u>	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 7 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ac anti-thyroglobuline (ATG)



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	VN: < 8 IU/ml	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 8 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ac anti-thyroperoxydase (TPO)



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervales de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	VN: < 8 IU/ml	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 9 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ac anti-transglutaminase



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	ALEGRIA ELISA Automatisée	< 10 U/ml Négatif ≥ 10 U/ml positif	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 10 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ac VHC



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600	vt > 1: Positif	ND	le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 11 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

ACE



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	<3 ng/ml	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 12 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Acide folique (vit B9)



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411	3,89 à 26,8 ng/ml	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 13 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Acide urique sang



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	Homme:35–85 mg/L Femme:25–62 mg/L	24H	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 14 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Acide urique urine



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600	250 - 750 mg/24H	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 15 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

ACTH



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411 ECLIA	7.2-63.3 pg/mL	<u>4 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 16 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

AFP (alpha foetoprotéine)



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411 ECLIA	Adulte <7	<u>24 H</u>	4h



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 17 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

AgHbS



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
	 	1 mL	Vitros XT 7600	Indice (E/S) < 0.9 : Négatif 0.9 < Indice (E/S) < 1: Douteux Indice (E/S) > 1: Positif	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 18 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Albuminémie



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	CHEM-7	35-50 g/l	<u>24h</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 19 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Amylase sang



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	CHEM-7	22-80 UI/l	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 20 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Amylase urines



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	CHEM-7	<320 UI/l	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 21 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Antigènes solubles

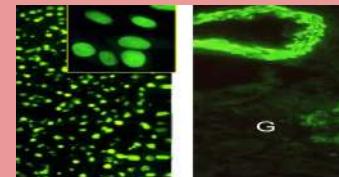

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	PLEX MAT4	+/-	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 22 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

AMH



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	AFIAS-10 FIA	*	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 23 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

ASLO



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	CHEM-7	< 200 UI/ml	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 24 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Béta HCG



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411 ECLIA	hCG ≤ 1 mUI/mL NÉGATIF hCG > 1 mUI/mL POSITIF	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 25 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Bêta HCG- Libre



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411 ECLIA	*	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 26 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Bilirubine



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	2–13 (mg/L)	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 27 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

C3 / C4



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	GPP-100 Immunonéphélo méttrie	C3: 0.9 - 1.8 g/L C4: 0.1 - 0.4 g/L	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 28 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ca 125

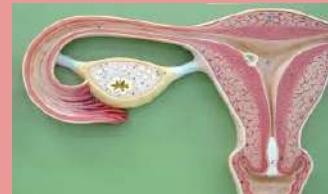

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	<35,0 U/ml	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 29 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ca 15.3



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	< 30,0 U/ml	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 30 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ca 19.9



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	< 37 U/ml	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 31 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Calcium sang



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	84,0–102,0 mg/L	24 H	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 32 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Calcium urines



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	100–300 mg/jour*	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 33 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Chimie des urines (CHU)



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	*	*	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 34 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Chlore sang



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	5,2–6,2 mmol/l	<u>< 6 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 35 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Cholestérol



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	< 2,0 (g/L)	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 36 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

LDL

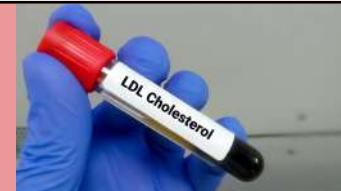

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	< 1,00 (g/L)	<u>Héparine < 8 H</u> <u>Sec 24 H</u>	le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 37 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Cla 30 (Pneumo et tropho)



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	PLEX MAT4 Immunoblot	0/+/-/++/+++	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 38 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Coproculture



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		(Noix de selles)	*	*	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 39 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Cortisol



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Immunodosage par compétition	45-227 ng/ml	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 40 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Cortisol Urinaire



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600	9,66-120,63 µg/24h	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 41 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

CPK



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage en cinétique	55-170 UI/l	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 42 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Créatinine sang



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 RT en 2 points	Femme: 5,2 - 10,4 mg/l Homme: 6,6-12,5 mg/l	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 43 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Créatinine urine



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600	1000-1700 mg/24 h	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 44 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

CRP

(Protéine C réactive)



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage immunologique en point fixe	< 10 (mg/L)	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 45 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

CRP HS



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	GPP100	<1,0 mg /l : Risque cardiovasculaire faible 1,0 à 2,9 mg /l : Risque cardiovasculaire intermédiaire >3,0 mg/l : Risque cardiovasculaire élevé	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 46 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

D-dimères



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	500 ng/mL	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 47 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

DNA Viral (Hépatite B)

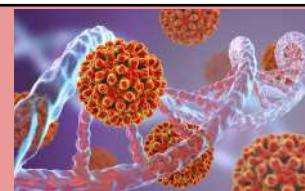

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Sacace PCR en temps réel	+/-	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 48 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

ECBU



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		*	Vitek compact 2	*	ND	2J



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 49 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Electrophorèse protéines sériques



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Minicap Electrophorèse	*	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 50 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Facteur rhumatoïde



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Alegria Elisa automatisée	< 20 IU/ml Négatif ≥ 20 IU/ml Positif	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 51 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Ferritine



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Immunométrique	17.9-464 ng/ml	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 52 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Fibrinogène



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	STA COMPACT MAX 3	2.4-4.5 g/l	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 53 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Frottis bactériologiques génitaux, ORL, pus...

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	*	*	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 54 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

FSH



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	1,7-12,0 mUI/mL	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 55 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

FT3



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage direct par immuno compétition	4,26 à 8,1 pmol / l	24 H	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 56 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

FT4



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411	11,9 à 21,6 pmol / l	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 57 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

GGT



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage en cinétique	12–58 (U/L)	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 58 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Glucose sang



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	0.7-1.1 g/l	<u>< 2 heures</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 59 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Glucose urines



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	+/-	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 60 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Groupe sanguin



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Carte gel Plaque : Agglutination	A/B/O/AB	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 61 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

HDL



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	Homme: > 0,40 (g/L) Femme: > 0,50 (g/L)	<u>< 6 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 62 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

HbA1c



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervales de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	TOSOH GX HPLC	< 5,6 : Non diabétique ou risque élevé d'hypoglycémie par insuline. 5,7 à 6,4 :Pré-diabète	<u>3 Jours</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 63 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

				<p>6 à 7 : Excellent équilibre glycémique (Diabète Non Insulino Dépendant)</p> <p>7 à 8 : Excellent équilibre glycémique (Diabète Insulino Dépendant)</p> <p>8 à 10 : Equilibre glycémique médiocre – Action corrective suggérée</p> <p>>10 : Mauvais équilibre glycémique – Action corrective nécessaire</p>		
--	--	--	--	--	--	--



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 64 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Hémoculture



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		40-60ml	Vitek Comapact2	*	ND	3J



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 65 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

HGPO (hyperglycémie provoquée) T0, T1, T2

HGPO50: femme enceinte T1



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	Glycémie à jeun chez l'adulte : T0 < 1g/l et G75 : <1,4 g/l Glycémie à jeun chez la femme enceinte doit être 0,92g/l et T2	<u>< 2 H</u>	24h



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011


Version: 01

Page 66 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

				<1,53	
--	--	--	--	-------	--

HIV



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411 ECLIA	Le rapport E/S est < 0.90 Négatif Le rapport E/S est ≥ 1.0: Positif	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 67 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

IgE totales



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411 ECLIA	240 ng/mL	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 68 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

LDH



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervales de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage en cinétique	120–246 U/L	< 2H	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 69 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

LH



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	1,1-7,0 mUI/mL	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 70 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Lipase



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 RT en 2 points	10–2000 U/L	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 71 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Liquide de ponction



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitek Compact 2	*	ND	3J



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 72 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Lithium

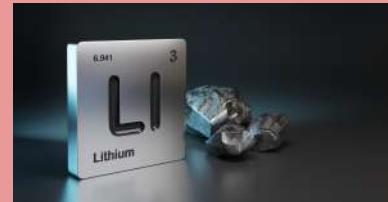

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	Thérapeutique : 0.50 à 1.2 Potentiellement toxique: 1.5 à 2.5 Très toxique:> 2.5	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 73 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

			(mmol/L)	
--	--	--	----------	--

Magnésium sang



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	16-23 mg/l	< 6 H	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 74 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Magnésium urines



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	73-122 mg/24h	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 75 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Micro albuminurie



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Point final en blanc	< 30 mg/g 250-750 mg/24h	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 76 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

NFS



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Mindray BC 780 Sysmex XN 1000	*	<u>6 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 77 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Œstradiol



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	Homme < 62 pg/ml Femme: Ovulation (J0): 93 à 575 pg/ml Phase folliculaire: 18 à 147 pg/ml Phase lutéale: 43 à 214 pg/ml	24 H	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 78 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

				Ménopause : < 58 pg/ml		
--	--	--	--	------------------------	--	--

Oxyurose



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		*	Examen direct	+/-	*	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 79 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Parasitologie des selles



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		Noisette	Examen direct	+ / -	*	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 80 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

PAPP-A



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411 ECLIA	*	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 81 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Phosphatases alcalines



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage en cinétique	38–126 U/L	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 82 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Phosphates sang



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	25–45 MG/L	<u>< 3 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 83 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Phosphates urines



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	400–1300 mg/jour	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 84 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Potassium sang



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage potentiométrique	3,5–5,1 mmol/L	< 2H	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 85 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Pro BNP



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	< 50 ans : 400 pg/ml 50 à 75 ans : 900 pg/ml > 75 ans : 1800 pg/ml	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 86 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Procalcitonine



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	<0,10 ng/mL Indique une absence d'infection bactérienne. Antibiothérapie fortement déconseillé 0,10-0,25 ng/mL Infection bactérienne improbable.	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 87 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

				<p>Antibiothérapie déconseillée.</p> <p>0,26-0,50 ng/mL Infection bactérienne possible. Antibiothérapie recommandée.</p> <p>>0,50 ng/mL Présence probable d'une infection bactérienne. Antibiothérapie fortement recommandée.</p>		
--	--	--	--	---	--	--



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 88 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Progesterone



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas Kube	0,25 à 0,54 ng/ml	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 89 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Prolactine



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	3-25 ng/ml	<u>< 24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 90 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Protéines totales sang



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	60–80 g/l	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 91 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Protéines urines

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	CHEM-7	<0,10 g/L <0,15 g/24h	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 92 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

PSA libre

**[PSA libre]
[PSA total]**

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	4 -10 ng/ml	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 93 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

PSA totale



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Immunodosage immunométrique	<4 ng/mL	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 94 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

PTH

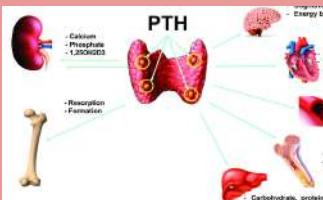

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	9,2 - 44,6 pg/mL	<u>Max 6 H sur tube sans anticoagulant</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 95 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

QTF



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	AFIAS-10 FIA	*	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 96 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Réserve alcaline



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1mL	Vitros XT 7600	22-30 mmol/l	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 97 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Réticulocytes

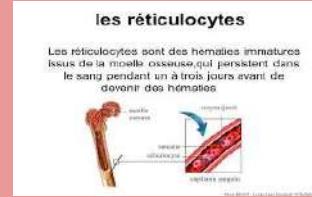

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Mindray BC-780/ Sysmex XN-1000 (Optique)	150.000 /mm3	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 98 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

RNA Viral (VHC)



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	SACACE PCR en temps réel	+/-	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 99 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Rubéole IgG



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411 ECLIA	≥ 10 UI/mL	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 100 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Sang dans les selles



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		Une noix de selles		+/-	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 101 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Sérologie Chlamydiae



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	ALEGRIA ELISA automatisée	Négatif < 20 U/ml douteux 20 - 25 U/m Positif > 25 U/ml	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 102 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Sérologie Syphilis



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas ECLIA	<p>Le rapport E/S est < 1.00 : Négatif</p> <p>Le rapport E/S est ≥ 1.00 : Positif</p>	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 103 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Sérologie toxoplasmose (IgG, IgM)

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411 ECLIA	Non réactifs: rapport E/S < 0.8 Douteux: rapport E/S ≥ 0.8 à < 1.0 Réactifs: rapport E/S ≥ 1.0	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 104 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Sodium sang



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage potentiométrique	137–145 mmol/L	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 105 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Spermoculture



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		La totalité de l'éjaculat	Examen direct+culture	*	ND	Analyse différée



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 106 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Spermogramme



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		La totalité de l'éjaculat	CEROS	*	ND	3J



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 107 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

TCA



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	STA COMPACT MAX 3	Normale: 30 - 36' Enfant: <40' Sous héparine: 45 - 90 '	<u>6 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats


Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 108 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Testostérone



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	AFIAS-10 ELFA	2.27-10.3 ng/ml	24 H	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 109 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Test Combiné MxA/CRP



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	AFIAS-10 ELFA	Infection bactérienne : MXA <15 et CRP ≥ 10 Infection virale : MXA ≥ 15 et CRP ≥ 10 ou MXA ≥ 15 et CRP < 10 Test Négatif : MXA < 15 et CRP < 10	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 110 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

TP/INR



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervales de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	STA COMPACT MAX 3	TP Spontané: 70 à 100 % TP sous AVK : 20 à 35 % Phlébite ou embolie pulmonaire: INR 2 à 3 Prophylaxie des thromboses veineuses: INR:2 à 3 Valve cardiaque: INR:3 à 4.5	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 111 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Transaminases (ASAT, ALAT)



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage en cinétique	ALAT Homme: < 35 UI/L Femme: < 50 UI/L ASAT Homme: 17–59 UI/L Femme: 14–36 UI/L	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 112 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Triglycérides



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage en cinétique	< 1,5 g/L	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 113 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Troponine HS



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas KUBE ELFA	VN :Homme < 25ng /L Femme <11 ng /L T0<2ng /L ou T0 et T2h <6ng/L : Exclusion d'un IDM T0>100 ng/L OU T2h-T0 >10ng/L : Inclusion d'un IDM Autre : Zone d'observation	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 114 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Toxoplasmose (IgM)

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411 ECLIA	Négatif: < 0.8 Douteux : [0.8-1.0] Positif : >= 1.0	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 115 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Toxoplasmose (IgG)

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalle de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas e411 ECLIA	Seuil : 10 UI/ ml	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 116 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

TSH



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Cobas ECLIA	0.27-4.2 µUI/ml	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 117 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Urée sang



Urée

<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	Homme: 0,19-0,43 g/L Femme: 0,15-0,36 g/L Enfant: 0,15-0,45 g/L	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 118 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Urée urine



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT 7600 Dosage colorimétrique	143,72–5405,40 (mg/dL d'urée)	ND	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 119 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Vitamine B12



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vidas Kube ELFA	166,9- 582,8 pg/ml	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 120 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Vitamine D



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	Vitros XT7600 Immunodosage par compétition	30 à 100 ng/ml	<u>24 H</u>	Le même jour



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 121 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri

Vitesse de Sédimentation (VS)



<u>Tubes préconisés</u>	<u>Tubes acceptables</u>	<u>Quantité à prélever Vol min ml</u>	<u>Automate et principe</u>	<u>Intervalles de référence</u>	<u>Stabilité (échantillon primaire)</u>	<u>Délai de rendu des résultats**</u>
		1 mL	MiniSed	<15 mm	ND	Le même jour

ND : non déterminé

* : Pas d'information disponible

Liens utiles: [Site Biomnis](#)

Pour les analyses de sous traitance:

Biomnis: le patient est contacté par téléphone

Laboratoire nationale: respecter le délai précisé sur le référentiel



Liste des examens, délais de reprise et de rendu des résultats

Code: OG-PA-011

Version: 01

Page 122 sur 122

Rédaction :	Vérification :	Approbation :	Application :
07/10/2025	-	08/10/2025	23/10/2025
Hela Ayari	-	Mongi Ayari	Souhir Ghorri